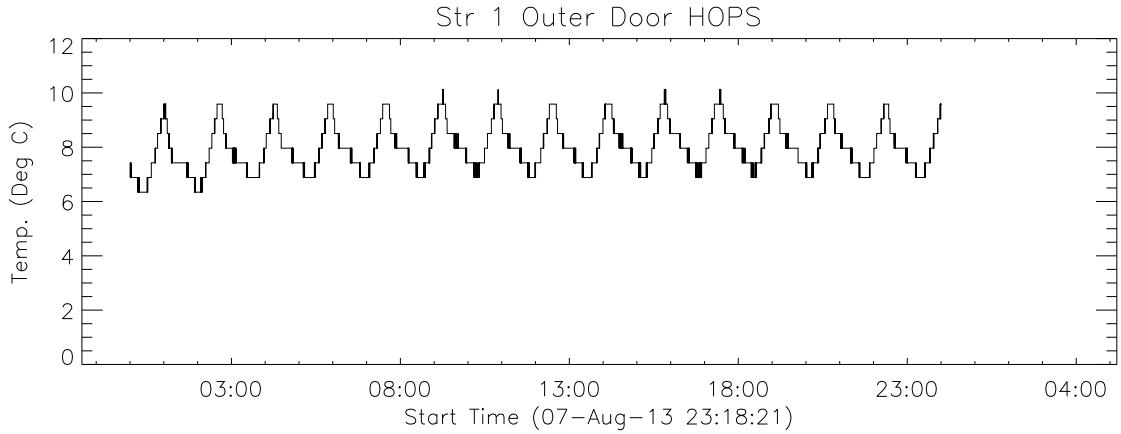
Str 1 Outer Door HOPS
Temp. (Deg C)
0
2
4
6
8
10
12
03:00
08:00
13:00
18:00
23:00
04:00
Start Time (07-Aug-13 23:18:21)

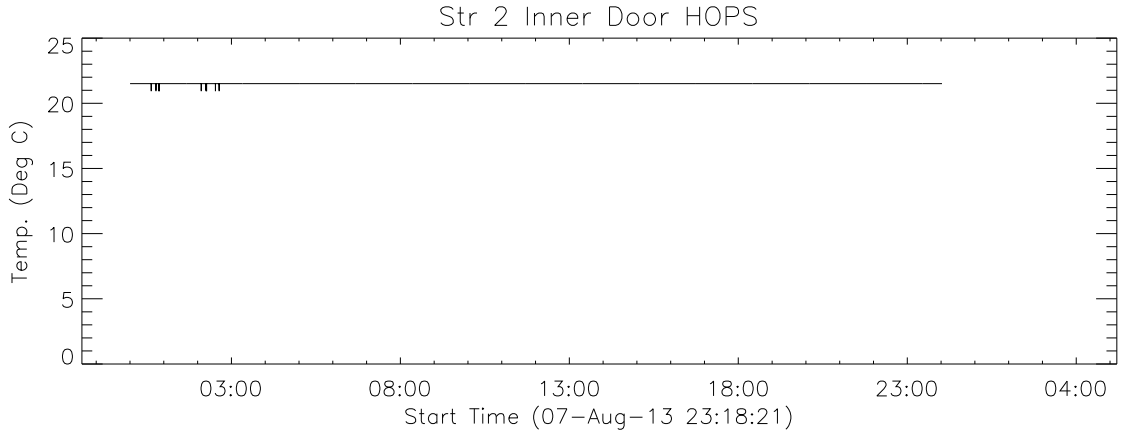
Str 2 Inner Door HOPS
Temp. (Deg C)
0
5
10
15
20
25
03:00
08:00
13:00
18:00
23:00
04:00
Start Time (07-Aug-13 23:18:21)

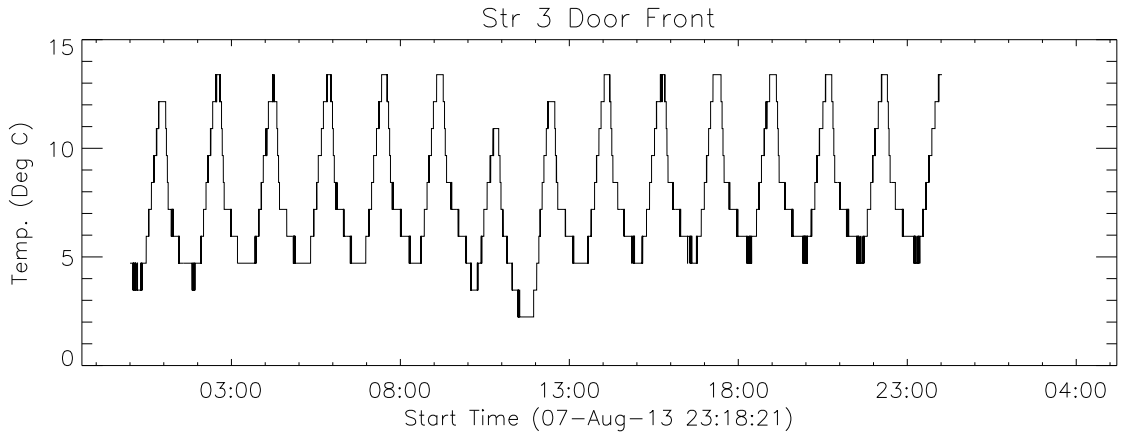
Str 3 Door Front
Temp. (Deg C)
0
5
10
15
03:00
08:00
13:00
18:00
23:00
04:00
Start Time (07-Aug-13 23:18:21)

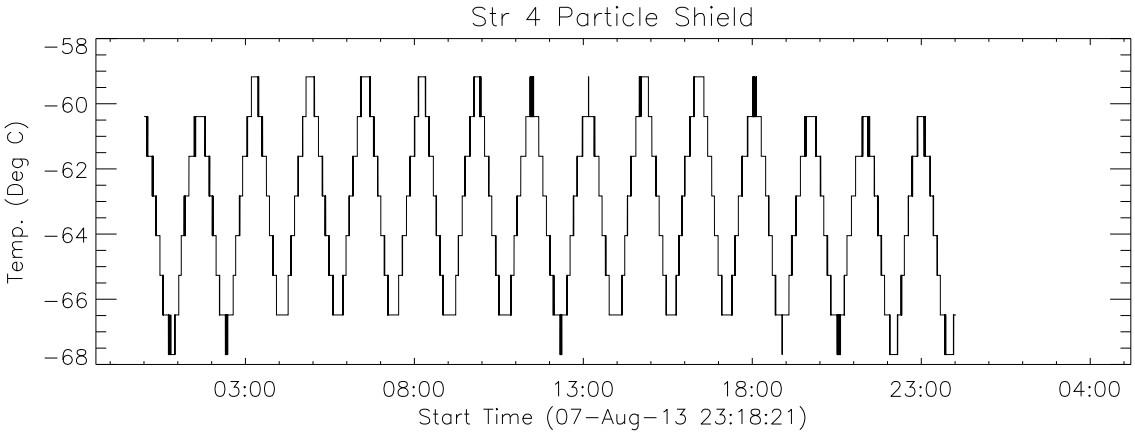
Str 4 Particle Shield
Temp. (Deg C)
−58
−60
−62
−64
−66
−68
03:00
08:00
13:00
18:00
23:00
04:00
Start Time (07−Aug−13 23:18:21)

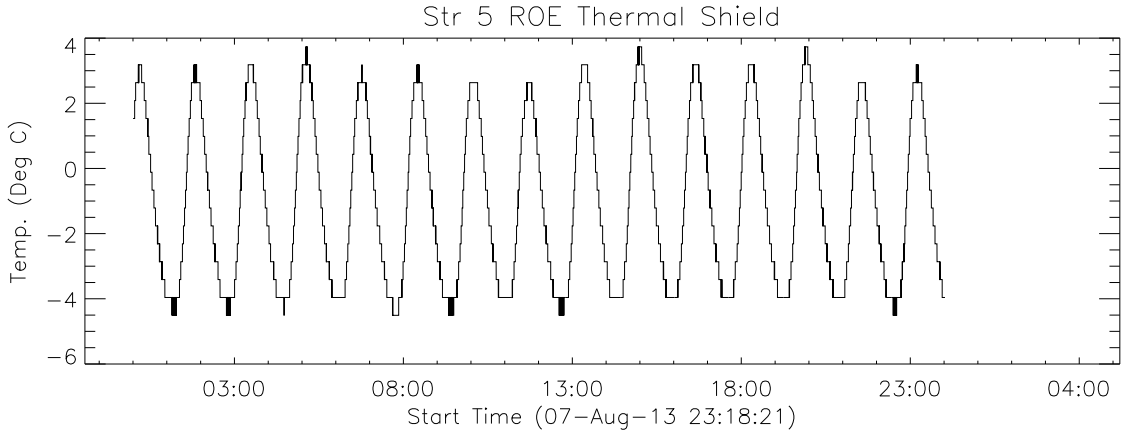
Str 5 ROE Thermal Shield
Temp. (Deg C)
4
2
0
−2
−4
−6
03:00
08:00
13:00
18:00
23:00
04:00
Start Time (07−Aug−13 23:18:21)

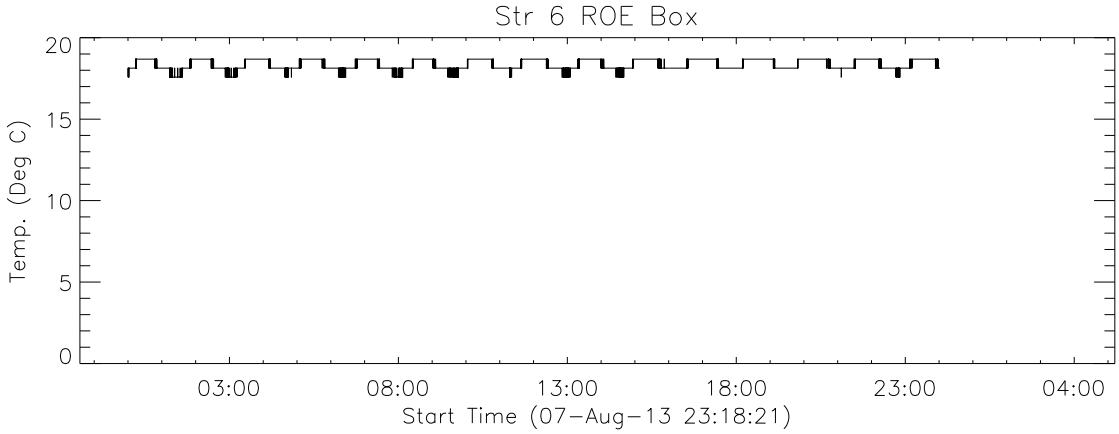
Str 6 ROE Box
Temp. (Deg C)
20
15
10
5
0
03:00
08:00
13:00
18:00
23:00
04:00
Start Time (07−Aug−13 23:18:21)

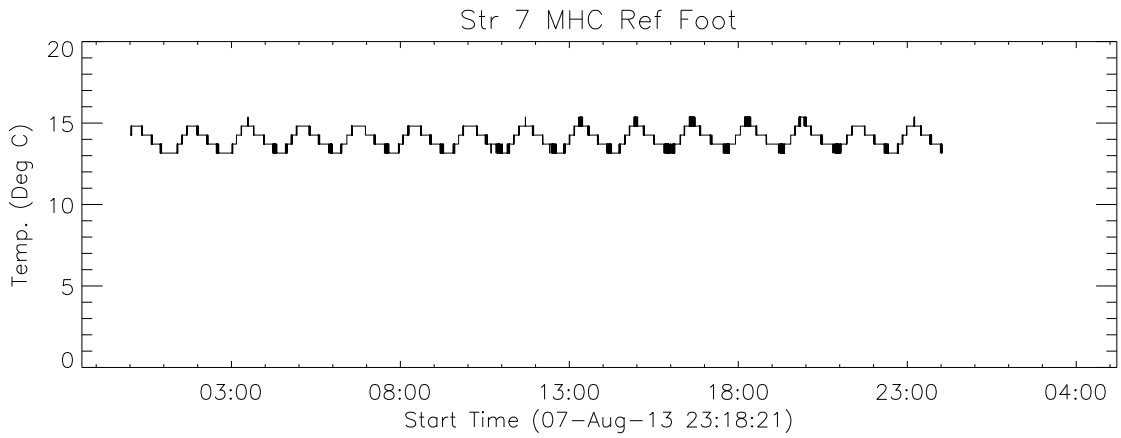
Str 7 MHC Ref Foot
Temp. (Deg C)
20
15
10
5
0
03:00
08:00
13:00
18:00
23:00
04:00
Start Time (07-Aug-13 23:18:21)