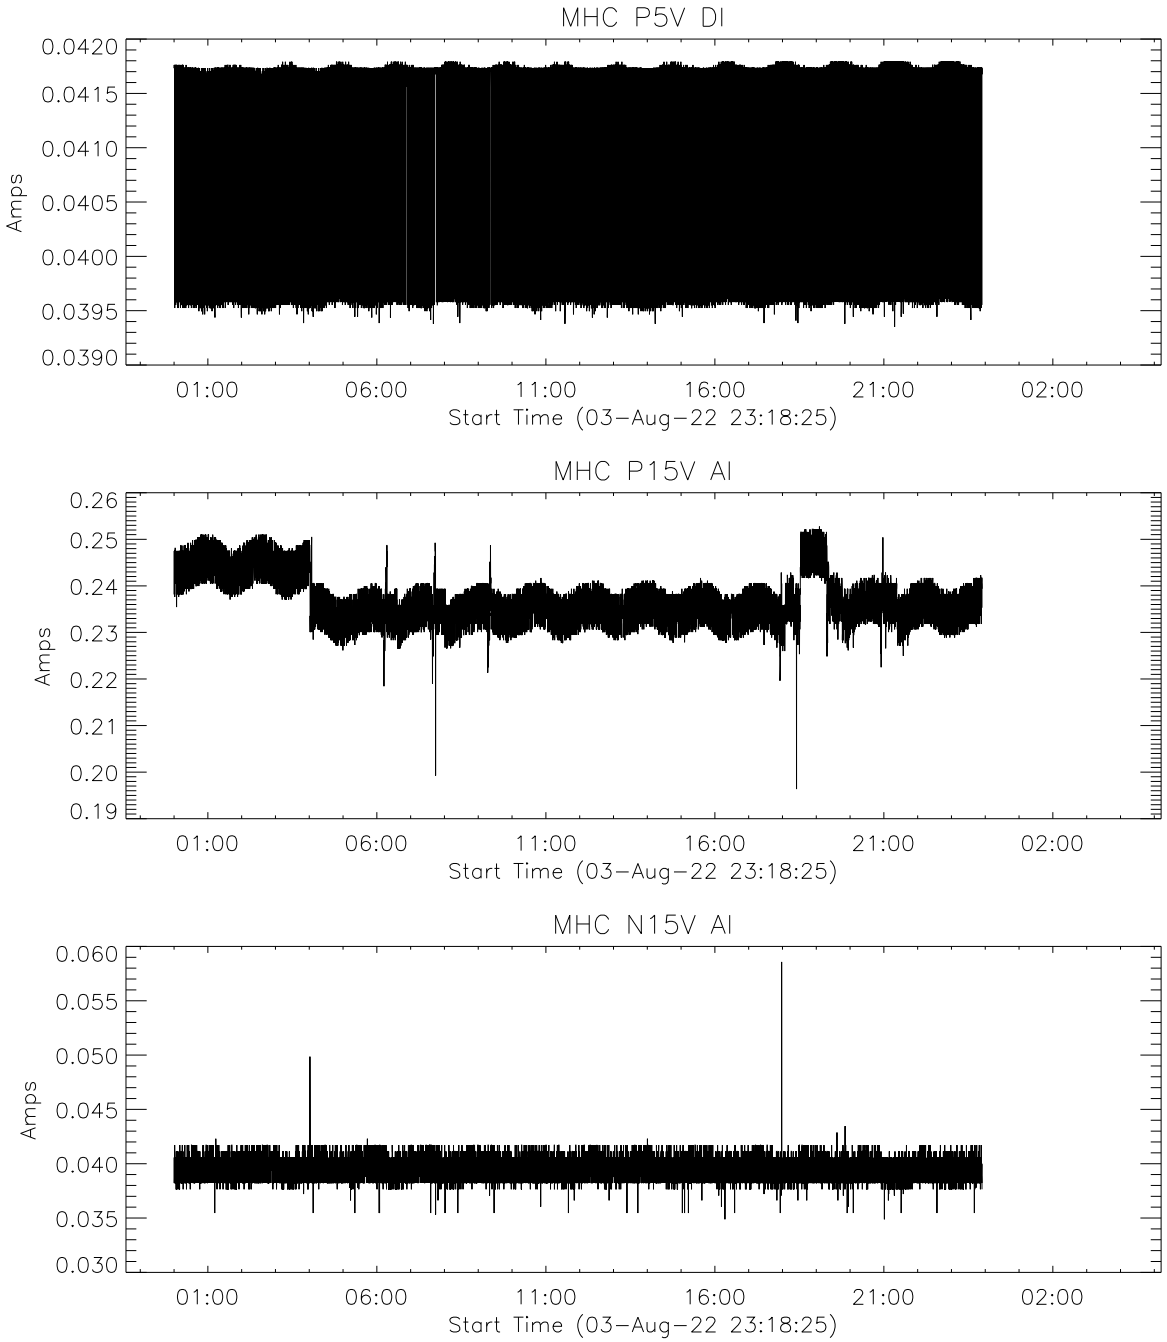
MHC P5V DI
Amps
0.0420
0.0415
0.0410
0.0405
0.0400
0.0395
0.0390
01:00
06:00
11:00
16:00
21:00
02:00
Start Time (03-Aug-22 23:18:25)
MHC P15V AI
Amps
0.26
0.25
0.24
0.23
0.22
0.21
0.20
0.19
01:00
06:00
11:00
16:00
21:00
02:00
Start Time (03-Aug-22 23:18:25)
MHC N15V AI
Amps
0.060
0.055
0.050
0.045
0.040
0.035
0.030
01:00
06:00
11:00
16:00
21:00
02:00
Start Time (03-Aug-22 23:18:25)

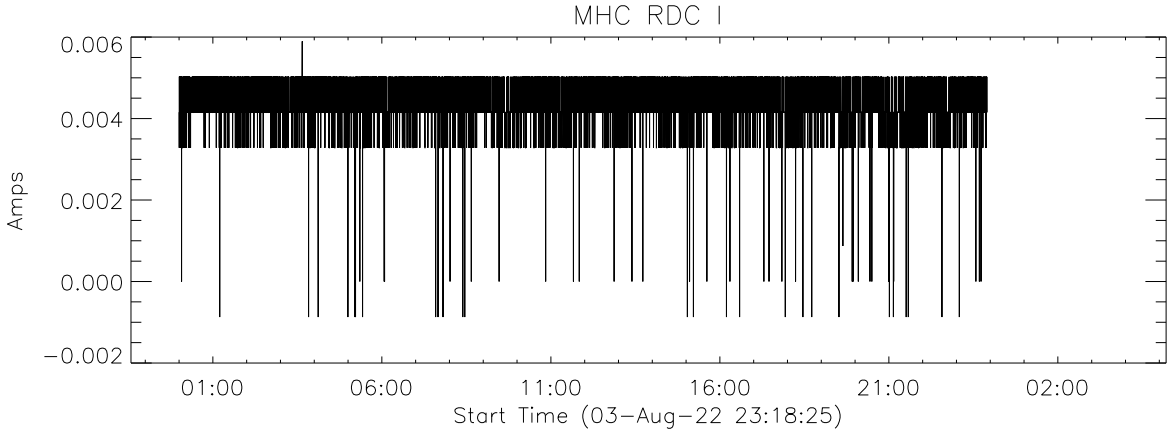
MHC RDC I
0.006
0.004
0.002
0.000
−0.002
Amps
01:00
06:00
11:00
16:00
21:00
02:00
Start Time (03−Aug−22 23:18:25)