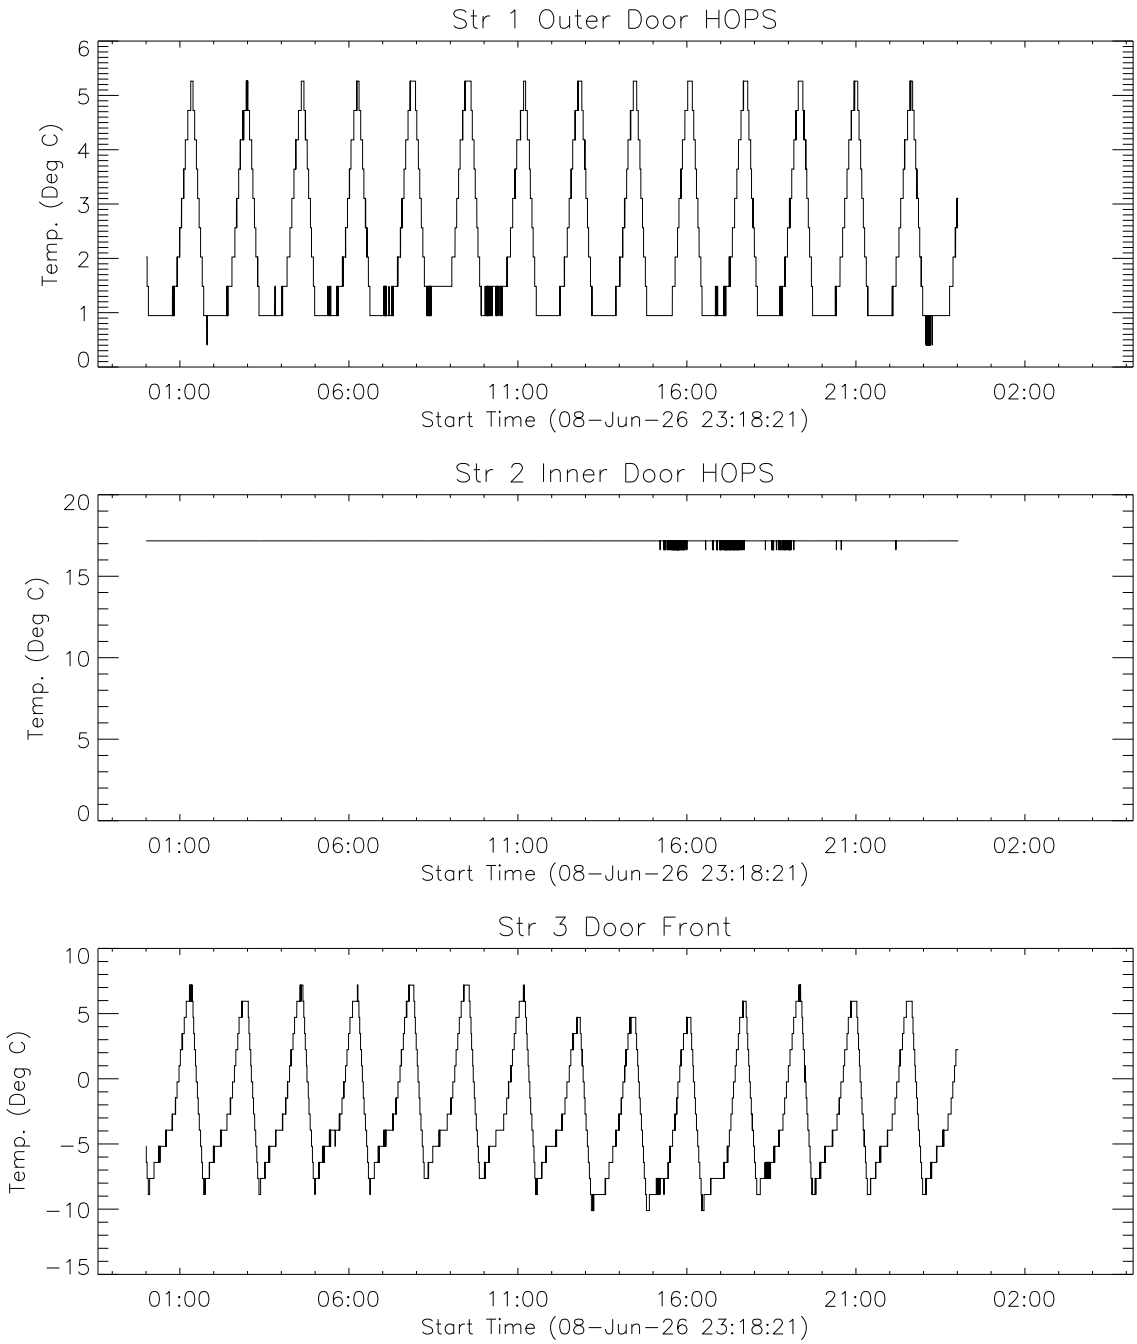
Str 1 Outer Door HOPS
Temp. (Deg C)
6
5
4
3
2
1
0
01:00
06:00
11:00
16:00
21:00
02:00
Start Time (08−Jun−26 23:18:21)
Str 2 Inner Door HOPS
Temp. (Deg C)
20
15
10
5
0
01:00
06:00
11:00
16:00
21:00
02:00
Start Time (08−Jun−26 23:18:21)
Str 3 Door Front
Temp. (Deg C)
10
5
0
−5
−10
−15
01:00
06:00
11:00
16:00
21:00
02:00
Start Time (08−Jun−26 23:18:21)

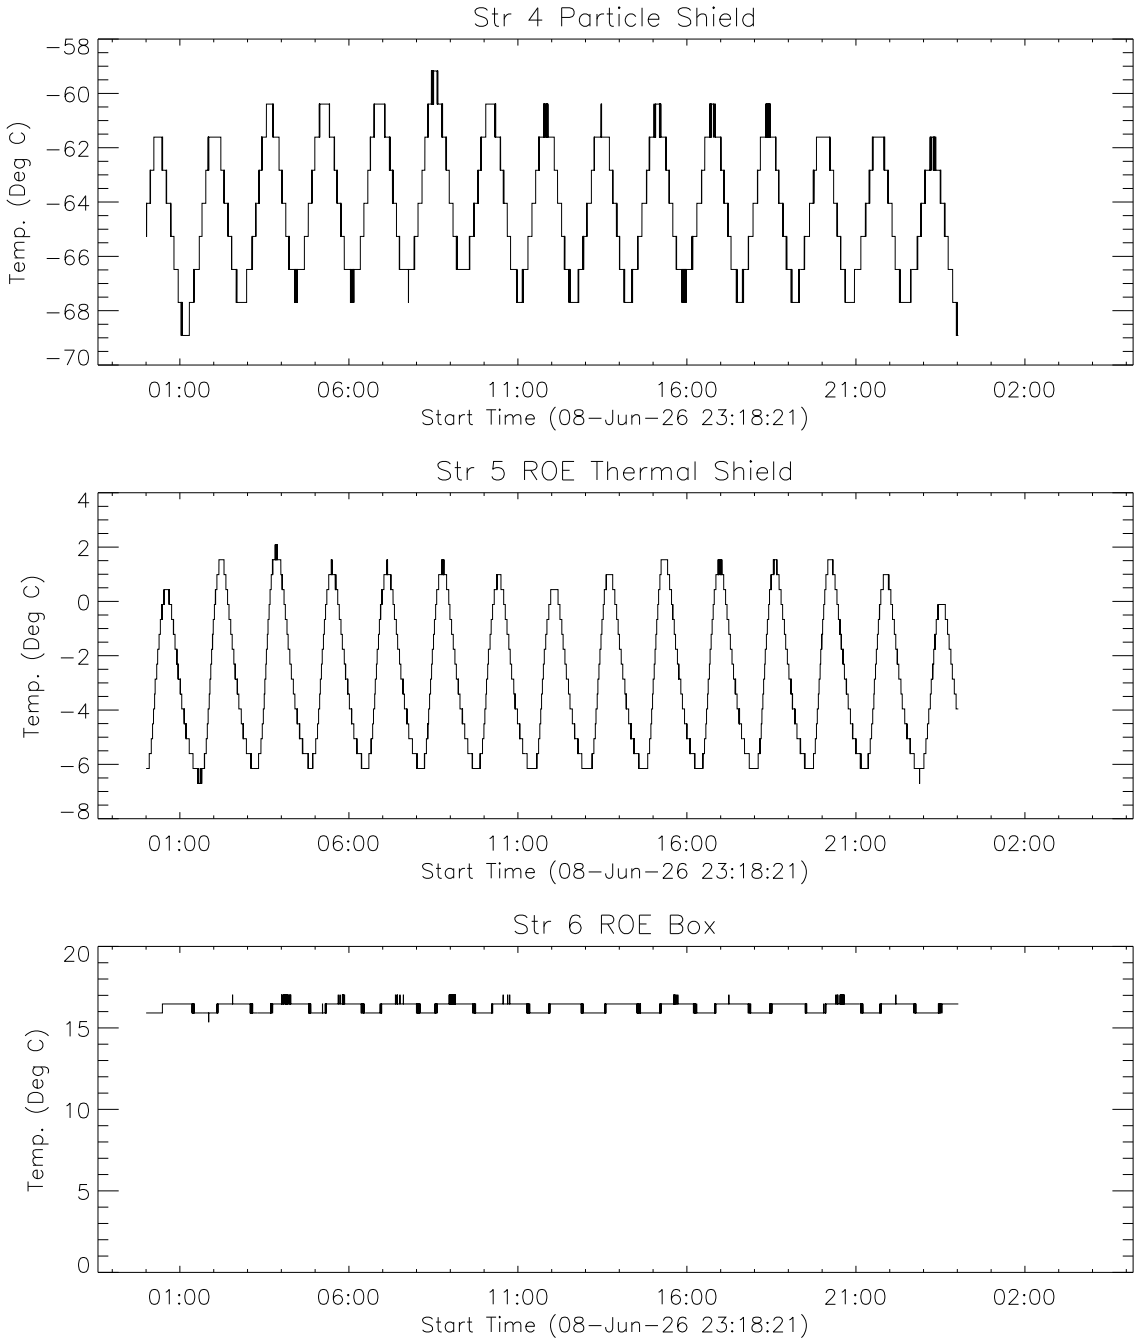
Str 4 Particle Shield
Temp. (Deg C)
−58
−60
−62
−64
−66
−68
−70
01:00
06:00
11:00
16:00
21:00
02:00
Start Time (08−Jun−26 23:18:21)
Str 5 ROE Thermal Shield
Temp. (Deg C)
4
2
0
−2
−4
−6
−8
01:00
06:00
11:00
16:00
21:00
02:00
Start Time (08−Jun−26 23:18:21)
Str 6 ROE Box
Temp. (Deg C)
20
15
10
5
0
01:00
06:00
11:00
16:00
21:00
02:00
Start Time (08−Jun−26 23:18:21)

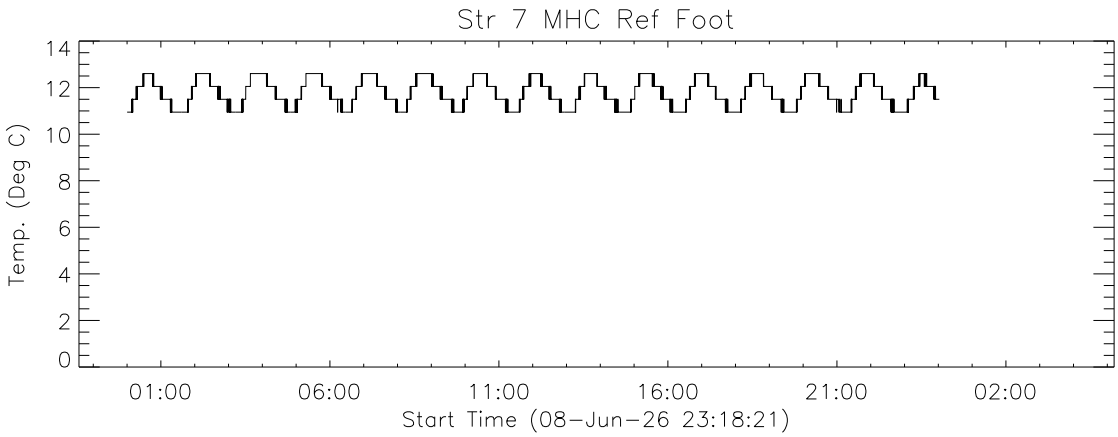
Str 7 MHC Ref Foot
Temp. (Deg C)
14
12
10
8
6
4
2
0
01:00
06:00
11:00
16:00
21:00
02:00
Start Time (08-Jun-26 23:18:21)