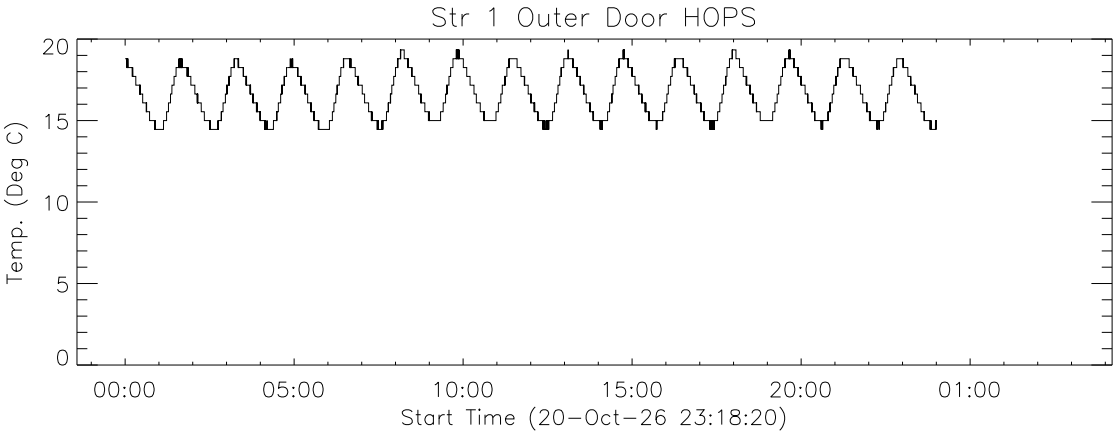
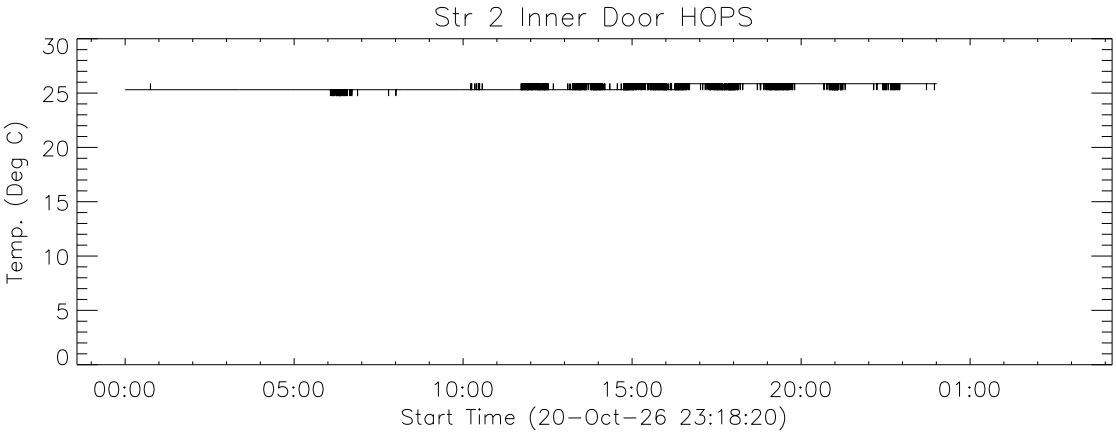
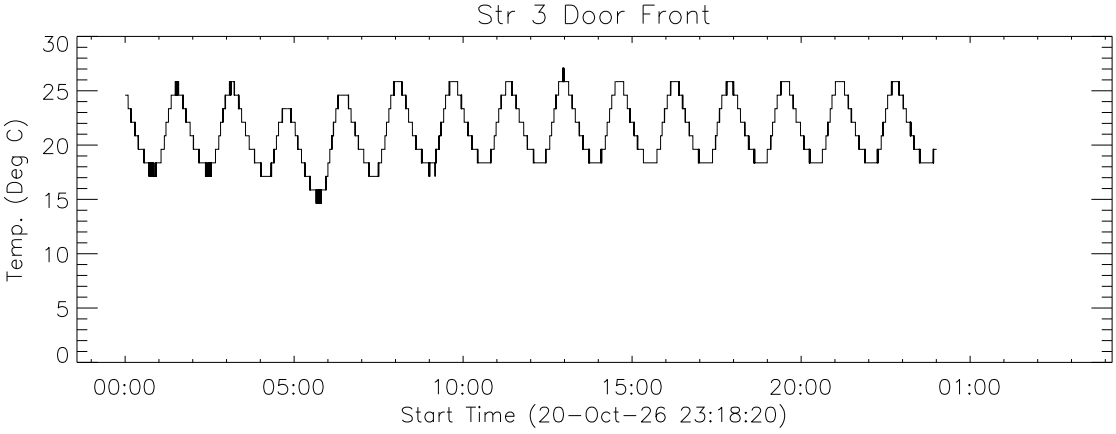
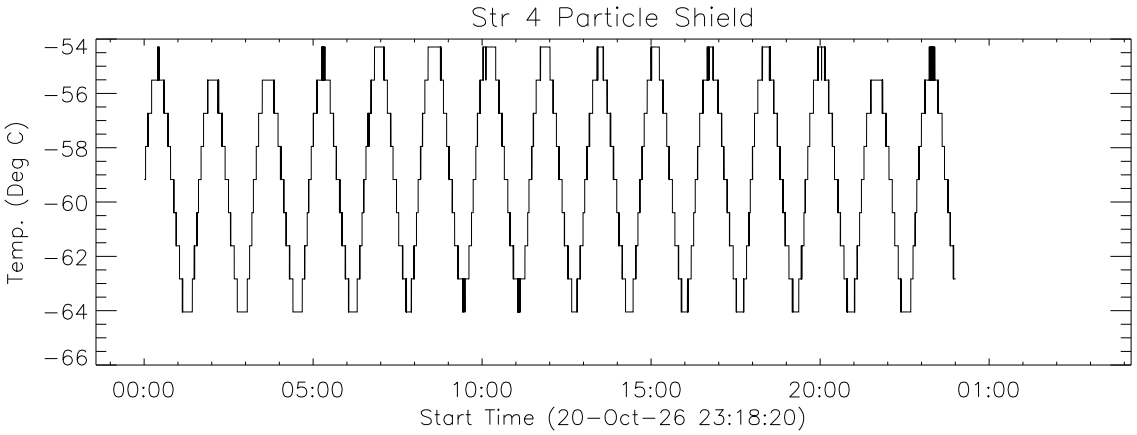
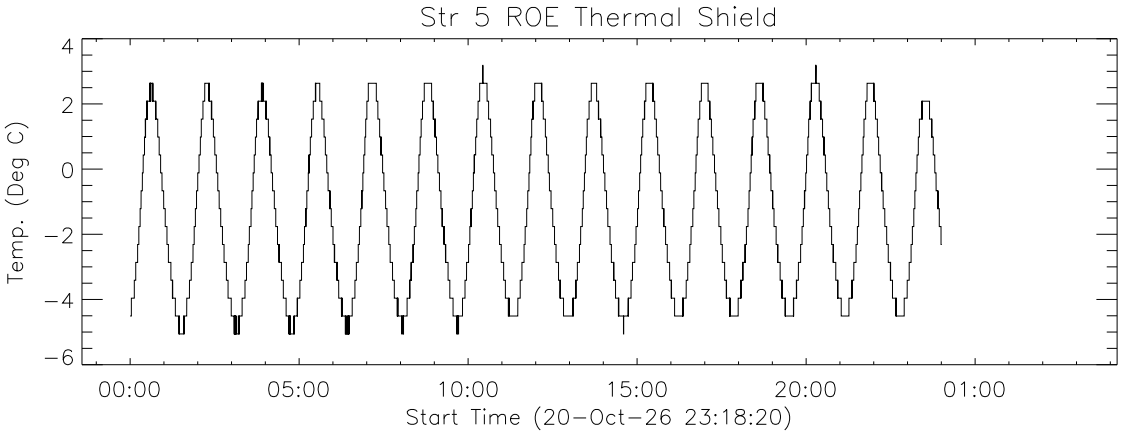
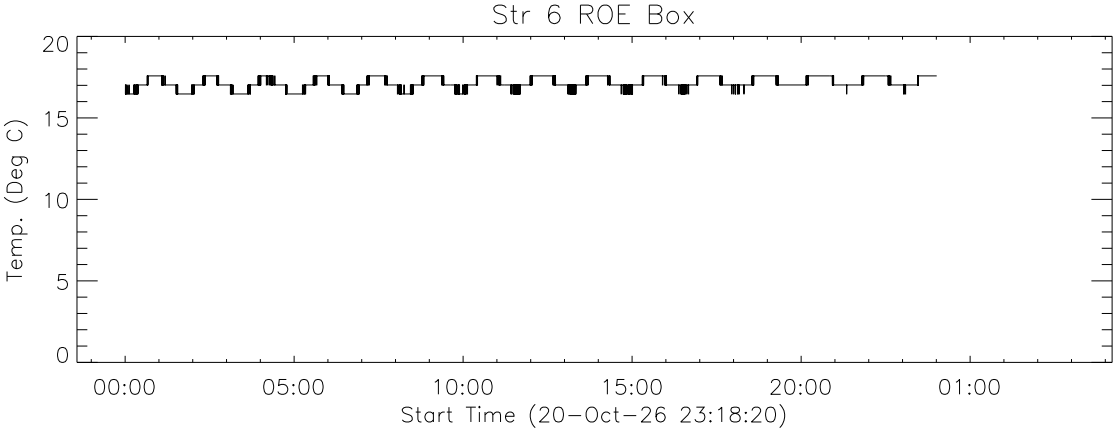

Str 1 Outer Door HOPS
Temp. (Deg C)
0
5
10
15
20
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
01:00
Start Time (20-Oct-26 23:18:20)

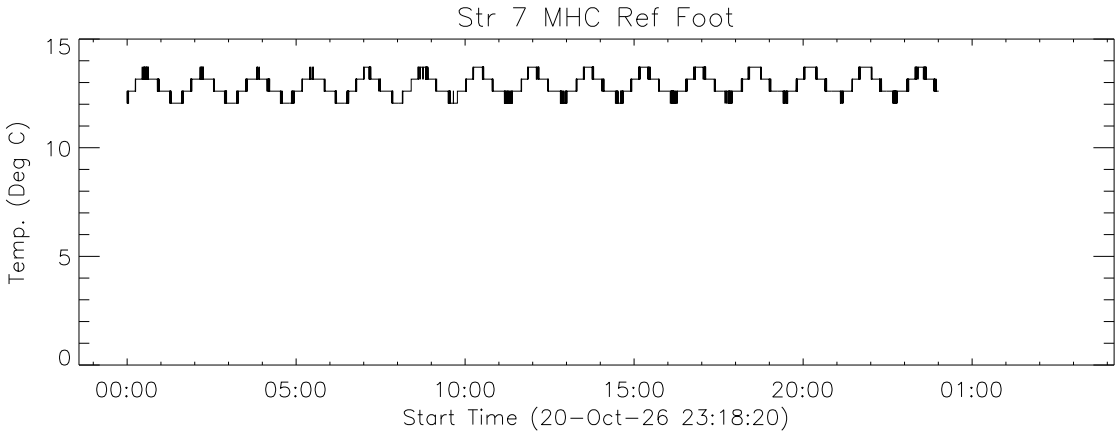

Str 2 Inner Door HOPS
Temp. (Deg C)
0
5
10
15
20
25
30
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
01:00
Start Time (20-Oct-26 23:18:20)


Str 3 Door Front
Temp. (Deg C)
0
5
10
15
20
25
30
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
01:00
Start Time (20-Oct-26 23:18:20)


Str 4 Particle Shield
Temp. (Deg C)
−54
−56
−58
−60
−62
−64
−66
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
01:00
Start Time (20−Oct−26 23:18:20)


Str 5 ROE Thermal Shield
Temp. (Deg C)
4
2
0
−2
−4
−6
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
01:00
Start Time (20−Oct−26 23:18:20)


Str 6 ROE Box
Temp. (Deg C)
20
15
10
5
0
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
01:00
Start Time (20−Oct−26 23:18:20)


Str 7 MHC Ref Foot
15
10
5
0
Temp. (Deg C)
00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
01:00
Start Time (20-Oct-26 23:18:20)